# Instruments
# de Chirurgie

**en Gomme inaltérable et stérilisable**
**et en Caoutchouc rouge moulé**

# DELAMOTTE

## 1789-1906

**Rondeau & Plisson**
68, Rue Jean-Jacques-Rousseau
PARIS

# Conditions de Vente

**Janvier 1906**

Toute première demande doit être accompagnée de bonnes références ou d'une valeur sur Paris

Les frais de **change**, ainsi que ceux de **port**, d'**emballage**, de **douane**, d'**assurance**, sont à la charge de l'**acheteur**.

Sauf avis contraire, les Expéditions sont toujours assurées.

Les Marchandises **non assurées** voyagent aux risques et périls du **destinataire**.

Les **Echantillons dits sans valeur** ne peuvent être recommandés que pour la **France et ses Colonies**; pour l'**Etranger**, ils sont considérés comme ayant une valeur passible des droits de douane, ils ne sont pas admis à la **recommandation**, ils ne sont expédiés ainsi que sur demande expresse et sans aucune garantie.

# Avantages de la fabrication DELAMOTTE

**Les Marchands en gros et détaillants** donnent la préférence à la **Marque DELAMOTTE** pour sa conservation indéfinie, son inaltérabilité absolue, c'est-à-dire pour des instruments résistants, tant à l'Équateur qu'aux Pôles, sans jamais se ramollir ni se durcir **Économie assurée**, plus de déchets invendables

**Les Chirurgiens et Médecins du monde entier** ordonnent la **Marque DELAMOTTE** parce qu'elle résiste la mieux aux différentes stérilisations, les instruments sont pratiques, perfectionnés, d'une fabrication régulière, fine, soignée et constamment tenue au courant des progrès de la science. Les instruments sont souples, résistants, préparés sans vernis, ils sont absolument garantis ne pas causer d'inflammation des muqueuses.

**Les malades exigent les Instruments de la Marque DELAMOTTE** pour leur poli spécial, inimitable, leur surface glacée indestructible assurant une pénétration douce et glissante; ces qualités de régularité font qu'ils ont confiance, de plus, elles assurent une longue durée d'usage et les rendent économiques

Les instruments en gomme blonde sont d'une grande souplesse, ceux en gomme noire sont demi-fermes. Ces derniers se recommandent aux personnes qui en font grand usage, ils sont préparés pour les grandes fatigues et les pays chauds.

Les instruments en caoutchouc sont garantis de Para 1re qualité, et vulcanisés avec la quantité de soufre strictement nécessaire à leur cuisson. Ils ont une surface lisse, unie, glacée, ils restent souples et sont de fort longue conservation.

*Ne pas mettre nos instruments en contact avec les instruments de qualité inférieure qui pourraient détériorer les nôtres en se collant à eux*

*Inutile de saupoudrer nos instruments par une poudre*

# Instruments de Chirurgie

## BANDAGES

EN GOMME POLIE SANS VERNIS ET EN CAOUTCHOUC MOULÉ

DE LA

## Maison DELAMOTTE

**INVENTEUR**
des premières Sondes
en
Gomme inaltérable

PLUSIEURS GRANDS PRIX
ET MÉDAILLES D'OR
aux
Expositions universelles

**CRÉATEUR**
de la Marque
universellement
appréciée

1789-1906
118e ANNÉE
de succès

Les plus hautes récompenses

Le nom de DELAMOTTE est la propriété de la Maison DELAMOTTE et ne doit servir que pour désigner des Instruments sortant de la Maison DELAMOTTE

### FOURNISSEUR AU CHOIX

des Facultés, des Hôpitaux civils de Paris, de Province et de l'Étranger, des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies, des Postes et Télégraphes, du Commerce, des Compagnies de Chemins de fer du Nord, de l'Orléans, du Paris-Lyon-Méditerranée, de l'État, des principales Compagnies de Navigation, de plusieurs armées et marines étrangères

## EN VENTE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE

Les Contrefacteurs seront poursuivis

# Renseignements généraux

## MARQUE DE FABRIQUE

Pour permettre à sa clientèle de distinguer plus facilement ses véritables produits, pour rendre la contrefaçon plus difficile la Maison « DELAMOTTE » a dû modifier sa marque de fabrique.

Tous les instruments de sa fabrication sont revêtus du signe distinctif ci-après *un croissant ou demi lune*, suivi lui même du nom DELAMOTTE

**DELAMOTTE**

Le dépôt de ces marques a été fait dans tous les pays. Les contrefacteurs seront poursuivis suivant la rigueur des lois

## CORRESPONDANCE IN ENGLISH

In order that their clients may the more easily distinguish their genuine articles and in order to render imitation more difficult MM DELAMOTTE have modified their former Trade Mark.

All instruments manufactured by them bear the distinctive signe of *a crescent or half moon*, followed by the name DELAMOTTE

**DELAMOTTE**

These Marks have been registered in all countries. Imitators will be prosecuted according to law.

## KORRESPONDENZ AUF DEUTSCH

Zur Vermeidung von Nachahmungen, und damit die geehrte Kundschaft ihre Fabrikate leichter unterscheiden kann, hat die Firma die frühere Fabrikmarke umgeändert

Alle unsere Instrumente und Fabrikate tragen nun nachstehendes Abzeichen *einen Halbmond oder eine Mondsichel* mit dem Namen

**DELAMOTTE**

Diese neue Marke ist in allen Ländern deponirt und gesetzlich geschützt. Nachahmungen werden auf Grund der bestehenden Gesetze gerichtlich verfolgt

Дабы дать покупателямъ своимъ возможность отличать дѣйствительныя его издѣлія, и дабы сдѣлать ихъ поддѣлку болѣе затруднительной. Торговый Домъ « ДЕЛЯМОТЪ » измѣнилъ свое фабричное клеймо

Отнынѣ всѣ инструменты его издѣлія будутъ отмѣчены слѣдующимъ отличительнымъ клеймомъ: полумѣсяцъ и вслѣдъ за нимъ фамилія ДЕЛЯМОТЪ

**ДЕЛЯМОТЪ**

Клеймо это заявлено во всѣхъ Государствахъ. Поддѣльщики будутъ преслѣдуемы по закону со всей строгостью

## SI CORRISPONDE IN ITALIANO

La Ditta « DELAMOTTE » per permettere alla sua clientela di distinguere i suoi veri prodotti, e renderne la contraffazione più difficile, ha modificato la sua marca di fabbrica

Tutti gl'instrumenti di sua fabbricazione sono rivestiti del segno distintivo qui appresso (*una crescente mezza luna*) seguita essa stessa dal nome DELAMOTTE

**DELAMOTTE**

Il deposito di queste marche è stato in tutti i paesi

I contraffattori saranno inseguiti a seconda del rigore delle leggi

## SE CORRESPONDE EN ESPAÑOL

Con el fin de permitir a su clientela de distinguir con mayor facilidad sus verdaderos productos y dificultar la competition, la Casa DELAMOTTE ha cambiado su antigua marca de fábrica

Todos los instrumentos de su fabricacion son revestidos de la señal distintiva que sigue *un creciente ó media luna*, a su vez seguido del nombre DELAMOTTE

**DELAMOTTE**

El deposito de referida marca se ha verificado en todos países. Se proseguira contra los falsificadores conforme al rigor de las leyes

# Bougies
## en Gomme Noire ou Blonde

POUR LES VOIES URINAIRES

### « MARQUE DORÉE »

Les bougies en gomme noire sont semi-rigides, celles en gomme blonde sont souples.

La Marque « **DELAMOTTE** » et le numéro sont imprimés en caractères dorés sur le corps de l'instrument.

Les numéros indiqués dans la désignation des instruments se rapportent à la filière divisée par 1/3 de millimètre, dite « **Charrière** ».

Toutes les bougies sont terminées par un bourrelet fermé et gommé, assurant ainsi l'occlusion complète.

## Bougies du n° 1 au n° 6 (Dites « Filiformes »)

Tissées sur crin de Florence, ces bougies offrent une grande résistance à la rupture ; elles sont assez rigides pour ne pas se plier, assez élastiques pour que l'introduction en soit facile et non dangereuse ; celles en gomme noire sont généralement les plus employées.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 | **Filiforme cylindrique** noire | La pièce | 1 » |
| 601 | — — blonde | — | 1 » |
| 602 | **Filiforme conique** noire | — | 1 » |
| 603 | — — blonde | — | 1 » |
| 604 | **Filiforme olivaire** noire | — | 1 » |
| 605 | — — blonde | — | 1 » |
| 606 | **Filiforme olivaire,** avec intérieur métallique, **du Dr Bazy,** prenant instantanément toutes les formes ou courbures que l'on peut désirer | — | 1 50 |
| 607 | **Filiforme olivaire** noire, avec pointe en spirale | — | 1 25 |

A

B

608 **Filiforme olivaire** noire, avec pointe baïonnette — La pièce 1 25

A.

B.

## Bougie filiforme à talon renforcé

Mettant à profit les conseils de *M. le Prof. Guyon* nous avons renforcé le talon des Bougies filiformes destinées à recevoir des montures de façon que la cassure ne se produise pas immédiatement sous le raccord, mais bien seulement à quelques centimètres de ce point.

Ainsi construites ces bougies constituent des conducteurs très efficaces.

## Bougies filiformes à raccords apparents

609 **Filiforme noire, avec raccord métallique apparent,** pas de vis femelle *pour Uréthrotomes* — La pièce 1 75

610 **Filiforme noire, avec raccord métallique apparent,** pas de vis mâle *pour Dilatateurs métalliques du Prof. Guyon et pour Bougies de Beniqué* — 1 75

Voir Réf. 645

## Bougies filiformes à raccords cachés

Modèles déposés sous le nº 10485

Frappé de la fragilité du mode de fixation des raccords posés après coup et dans le but de donner une plus intime adhérence aux montures, le Dr E. R. W. Franck, a imaginé de faire fixer les raccords sur la tige même de la Bougie au début du travail, et de recouvrir ensuite le tout d'un second tissu enveloppant les deux pièces ainsi réunies. Une expérimentation de plusieurs années nous a montré que par ce moyen on obtient une plus grande résistance à l'usage.

A cet effet nous tenons à la disposition de nos clients des squelettes de filiformes à talon renforcé sur lesquels ils pourront eux-mêmes fixer leurs raccords. Une fois ces squelettes retournés à notre maison 10 à 12 jours sont nécessaires pour achever la fabrication. Nous rappelons à ceux de nos clients qui nous chargent du soin de faire fixer les raccords, qu'ils doivent toujours accompagner leur commande d'un modèle du pas de vis qu'ils désirent recevoir.

Tous les raccords à vis mâle de nos montures ont leur pas de vis précédé d'une partie plus fine et non filetée qui permet un emboîtement plus facile et rapide (Modification du Dr Gouriet).

611 **Filiforme à raccord caché,** pas de vis femelle *pour Uréthrotomes et Sondes* — La pièce 2 25

Voir Réf. 693

612 **Filiforme à raccord caché,** pas de vis mâle *pour Dilatateurs métalliques du Prof. Guyon et pour Bougies de Beniqué* — 2 25

Voir Réf. 615

613 **Filiforme noire, double longueur,** *servant de conducteur dans le cathétérisme par glissement* (Procédé de Maisonneuve) — 2 50

Voir Réf. 674 à 676

614 **Filiforme double longueur** *et à vis de piston, du Dr Hamonic, servant de conducteur pour ses Bougies dilatatrices en métal et ses Sondes en gomme* — La pièce 3 »



615 **Bougie filiforme uréthérale du Dr Albarran** (voir Réf 738) — La pièce 5 »

616 **Bougie en Baleine à olive,** du nº 1 au nº 6 Charrière — 1 50
617 — — — du nº 7 au nº 15 — — 2 50

618 **Bougie en Baleine à olive,** à extrémité coudée, en baïonnette ou en spirale, du nº 1 au nº 6 Charrière — 2 »

A

B

619 **Bougie en Boyau,** du nº 1 au nº 9 Charrière — 1 25
620 — — du nº 10 au nº 18 Charrière — 2 »

**Bougie en Laminaria,** 7 centimètres

| | | | |
|---|---|---|---|
| 621 Bougie pleine du nº 4 au 19 | La pièce | » 50 | 622 Bougie creuse du nº 9 au 19 | La pièce | » 75 |
| — — — 20 au 23 | — | » 75 | — — — 20 au 22 | — | 1 » |
| — — — 23 au 25 | — | 1 » | — — — 23 au 25 | — | 1 25 |

## Bougies Vésicales du nº 7 au nº 30 (Charrière)

Les Bougies de gros calibre sont avec tissu renforcé, leur souplesse demeure la même, l'aplatissement des parois n'étant plus possible, elles remplacent avantageusement les Bougies Benìqué

Leurs numéros de grosseur sont imprimés en caractères dorés et se rapportent à la filière Charrière

Elles sont terminées par un nouveau bouchon à vis les occlusant d'une façon absolue, tout en permettant de le retirer pour introduire au besoin de la grenaille, du mercure ou un mandrin

623 **Bougie cylindrique** noire — La pièce » 60
624 — — blonde — » 60
625 — — noire, *intérieur grenaille ou tige de plomb* } Bien spécifier — » 90
626 — — blonde — — — » 90

627 **Bougie conique** noire — La pièce 1 »
628 — — blonde — 1 »
629 — — noire, *intérieur grenaille ou tige de plomb* } Bien spécifier — 1 30
630 — — blonde, — — — 1 30




631 **Bougie olivaire du Dr Guillon,** noire — La pièce 1 »
632 — — — blonde — 1 »
633 — — — noire, *intérieur grenaille ou tige de plomb* } Bien spécifier — 1 30
634 — — — blonde — — — 1 30

Cône allongé

Cône court

635 **Bougie olivaire** noire, *tissu de soie*, à pointe blonde, *extrémité très souple* La pièce 1 50
636 La même, *avec grenaille de plomb* — 1 80

637 **Bougie du Dr Langlebert,** noire (*dilatation successive immédiate*) La pièce 4 »

638 **Bougie à ventre de Ducamp,** noire La pièce 2 »

639 **Bougie à renflements successifs de Mallez,** noire La pièce 2 50

640 **Bougie à extrémité filiforme longue de Legonest,** blonde La pièce 2 25

641 **Bougie dilatatrice de Lésl,** blonde, pointe de 15 centimètres La pièce 2 25

642 **Dilatateur du Dr Hamonic,** noir
Nº 1 Bougie complètement conique Nº 15 Avec pointe, Nº 2 Charrière La pièce 4 50
Nº 2 — — — Nº 24 — Nº 4 — — 4 50

0,70

La même vue d'ensemble

Le Dr Hamonic estime que leur introduction est des plus aisées. Grâce à leur souplesse ils se replient dans le sens [illegible] ... Avec leur aide on fait rapidement ce que l'on ne peut réaliser que lentement avec les Bougies ordinaires (*Traité des Rétrécissements de l'Urèthre*, [illegible]).

643 **Bougie cravache du Dr Harrisson,** régulièrement conique, se fait en 50 c/m de longueur, depuis le nº 12 jusqu'au nº 24 Charrière. La pièce **3 »**

Construite en gomme blonde très souple cette Bougie est fort appréciée par les praticiens

0m 50

644 **Les mêmes, du Dr Harrisson,** *intérieur grenaille de plomb* La pièce **3 50**

## Plombage des Bougies

On modifie le degré de résistance des Bougies, on augmente leur poids par le plombage en ayant recours à l'un des procédés ci-après, qu'on voudra bien chaque fois nous désigner.

1º **La grenaille de plomb** donne des Bougies fermes, souples et lourdes, d'une introduction très aisée, qui sont un intermédiaire entre les Bougies flexibles et les cathéters métalliques. S'emploie utilement du nº 14 au nº 30.

2º **Le mandrin de plomb** augmente la rigidité des Bougies, permet de leur faire prendre instantanément toutes les courbures. S'emploie utilement du nº 20 au nº 22, au dessus de ce calibre la rigidité est trouvée un peu grande.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 645 **Bougie dilatatrice en métal du Prof. Guyon,** | nº 24 à 29 (filière Beniqué) | La pièce | **2 »** |
| — — — — | nº 30 à 39 — | — | **2 30** |
| — — — — | nº 40 à 49 — | — | **2 60** |
| — — — — | nº 50 à 60 — | — | **3 30** |

Le nº des Bougies métalliques est égal au nº Charrière multiplié par 2

646 **Bougie conductrice avec raccord métallique apparent,** pas de vis mâle La pièce **2 »**
Voir Réf. 610

647 **Bougie conductrice avec raccord caché,** pas de vis mâle La pièce **2 25**
(*Déposé nº 10 185*) Voir Réf. 612

648 **Boîtes** en noyer ou métal pour ces dilatateurs. *Prix suivant la composition.*

# Explorateurs

[illegible] indications du Prof. Guyon, nous avons diminué notablement le calibre de la tige des explorateurs. Malgré cette modification, la tige conserve une rigidité suffisante pour conduire la boule.

650 **Explorateur du Prof. Guyon,** noir, du n° 5 au n° 30 . . . . . La pièce **1 25**

651 **Explorateur du Prof. Guyon,** avec graduation ineffaçable, blond et noir . . . La pièce **2 »**

Tous les [illegible] c/m la graduation [illegible] est [illegible] large pour faciliter le repérage.

652 **Les mêmes,** avec graduation en dorure, *un trait par c/m* . . . . . La pièce **2 »**

653 **Explorateurs à deux boules,** blond, *une boule coupée d'angle et une boule grosse olive.* . . . . . La pièce **1 50**

654 **Explorateur de Mallez** à boule coupée d'angle et à extrémité olivaire, *du n° 8 au n° 30* . . . . . La pièce **1 75**

655 **Explorateur conduit du D^r Janet,** noir, n^os 18, 20, 22, 24 . . . . . La pièce **2 25**

Pour bien établir le diagnostic entre le rétrécissement bulbaire et le spasme membraneux, le D^r Janet conseille l'emploi d'Explorateurs [illegible] d'un prolongement filiforme donnant [illegible] les conducteurs. La boule de ces Explorateurs franchit aisément un spasme urétral et s'arrête devant un rétrécissement bulbaire.

656 **Explorateur Lancéolé du D^r Hamonic,** noir, du n° 18 à 24 . . . . . La pièce **2 50**

Exploration des rétrécissements larges et des rétrécissements bulbaires d'un diagnostic difficile. Les sensations étant recueillies par l'équateur de la boule [illegible] par une surface circulaire presque linéaire, parviennent en totalité aux doigts de l'observateur et ne se perdent pas [illegible] tangent [illegible]

657 **Explorateur Pariétal du D^r Hamonic,** noir . . . . . La pièce **2 50**

Permettant d'explorer isolément la paroi supérieure ou inférieure de l'urèthre ; la position de la lentille est indiquée par un petit index placé près de l'extrémité [illegible]

658 **Explorateur acoustique, pour calculs vésicaux, du D^r Cochemé,** en gomme souple avec extrémités métalliques . . . . . La pièce **7 »**

Ces Explorateurs d'une introduction facile [illegible] grâce à son cornet [illegible] de percevoir l[illegible] produit sur le bec de l'instrument.

# Bougies Électriques

659 **Bougie électrique de Mallez** — La pièce **3 50**

660 **Série d'Olives du Prof. Guyon**, avec conducteur — La pièce **20 »**

661 **Électrolyseur pour l'Urèthre** — La pièce **15 »**

Sur demande, nous pouvons remplacer les tiges généralement employées en métal rigide par d'autres en métal plus souple.

**Sur ces modèles, nous construisons des Électrolyseurs pour l'œsophage.**

Le garnissage en gomme de tous les Électrolyseurs, Conducteurs, Appareils électriques, exige un travail d'une huitaine de jours, et le prix peut en varier de **5 à 10** fr.

Spécialement pour les constructeurs-électriciens, nous fabriquons Bougies, tubes, etc., formant isolateurs, à des prix variant suivant qualité et quantité.

N. B. — Le poli brillant qui distingue les sondes DELAMOTTE, et leur donne cette surface unie, glacée, qui les rendent si parfaitement glissantes, n'est pas dû à l'emploi du vernis. Il est uniquement le résultat d'un long travail manuel.

**CONSERVATION DES INSTRUMENTS EN GOMME DELAMOTTE**

*Tenir ceux-ci dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité; de temps à autre les débarrasser de la poussière qui se dépose à leur surface en les frottant légèrement avec une peau de chamois ou un linge bien sec.*

# Sondes Vésicales

## en Gomme Noire ou Blonde

### « MARQUE JAUNE »

Ces Sondes possèdent les qualités de conservation, de durée, de résistance des Sondes « Marque Dorée » (voir pages 11 et 12). Elles sont livrées coiffées d'un bourrelet en os, les yeux sont du genre tissé et aseptiques.

Se font avec un œil depuis le n° 4 jusqu'au n° 30, longueur 35 centimètres.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 662 | **Sonde cylindrique droite** noire | La pièce | » 55 |
| 663 | — — — blonde | — | » 55 |
| 664 | **Sonde conique** noire | La pièce | » 85 |
| 665 | — — blonde | — | » 85 |
| 666 | **Sonde olivaire** noire | La pièce | 1 » |
| 667 | — — blonde | — | 1 » |
| 668 | **Sonde à béquille** noire | La pièce | 1 10 |
| 669 | — — blonde | — | 1 10 |

Réf. 670 — **Pince Index DELAMOTTE** — La pièce » 10 — Le cent 8 »

**s'adaptant instantanément sur tous les Instruments de Chirurgie : gomme, caoutchouc, métal, etc.**

*Modèle Déposé sous le n° 19 751*

Notre **Pince Index**, en métal nickelé, après de nombreux essais, a été reconnue comme étant ce qui se fait de plus pratique et de plus commode.

**AVANTAGES.** — 1° Elle se place et s'enlève à volonté sur le godet des Sondes ou des Bougies déjà existantes.

Fixé pour l'emploi — Déplacé pour la stérilisation

2° La petite ogive formant une saillie longitudinale très sensible au toucher permet, même la nuit, de donner une bonne direction aux yeux, à la béquille ou aux courbures des instruments. Le médecin ou malade connaît vite dans quel sens il doit la placer pour recueillir les meilleurs résultats d'une douce pénétration (Les yeux d'une sonde bien conduite s'usent beaucoup moins vite).

3° Déplacée, elle ne gêne pas pour la stérilisation.

4° Passe prolongeant une rallonge, votre Pince lui assure une plus grande durée.

5° Permet d'accrocher les Sondes après le lavage pour les laisser égoutter et sécher.

Sondes en caoutchouc : voir page 27

# Sondes Vésicales
## en Gomme Noire ou Blonde

### « MARQUE DORÉE »

A la demande de beaucoup de nos clients, nous avons fabriqué depuis quelques années des Sondes en **tissu de soie** recouvertes de notre gomme **DELAMOTTE**. Ces Sondes nous ont valu les **plus hautes récompenses** dans les dernières Expositions, **Grand Prix SAINT-LOUIS 1904**, **Grand Prix et Médaille d'Or à LIÉGE 1905**.

Aussi, ne voulant produire industriellement et avoir en stock des Sondes en soie qu'après avoir reçu toutes les observations et critiques que nous avions sollicitées de tous les Professeurs et Docteurs de tout l'univers, et celles-ci nous étant parvenues toutes plus élogieuses les unes que les autres, nous sommes heureux de prévenir notre clientèle mondiale que nous sommes en mesure de pouvoir satisfaire tous ses besoins en Sondes tissu de soie recouvertes de notre gomme **DELAMOTTE**.

Les nouvelles Sondes, **en soie de Bombyx**, tissées sur des métiers de haute précision et de dispositif spécial, ont un tissu régulier tissé de 36 mèches composées de 2 ou 3 fils et chaque fil de 3 brins, ce qui donne à chaque instrument un tissu constitué de 216 à 324 fils de **soie pure**, d'où le **MAXIMUM DE SOLIDITÉ**.

Le tissu ainsi fabriqué offre la **plus grande résistance à la traction et à la compression** ; il ne s'allonge pas et ne peut rompre, il donne à la Sonde une force de pénétration incomparable, sans crainte de se plier, tout en acquérant une souplesse plus grande que celle du caoutchouc. Aussi les Sondes ainsi fabriquées sont-elles celles préférées par tous les Chirurgiens, car, disent-ils, avec elles pas d'obstacles, on passe toujours sans occasionner de douleur sur les muqueuses sensibles, **mises à demeure**, elles ne gênent pas le malade qui peut vaquer à ses occupations.

Cette grande solidité nous a permis de faire des Sondes à **paroi extrêmement mince** et d'obtenir ainsi le **canal intérieur le plus grand**, aussi, après les **lithotrities** il n'est plus besoin d'avoir recours à la Sonde évacuatrice en métal. On obtient, mais sans douleur, la même rapidité d'écoulement, tous les graviers sont facilement expulsés au dehors. Les lavages sont **abondants et rapides** surtout avec les Sondes à deux yeux ; ils produisent un remous très fort qui fouille énergiquement tous les replis de la tunique intérieure de la vessie et en assure le **nettoyage complet**.

Les yeux de nos Sondes en soie, tous garantis **tissés**, sans coupure d'aucun fil, sont, avant le gommage, **surlés et cousus à la main** comme on pourrait le faire pour une boutonnière de vêtement, ainsi constitués ils sont solides, peuvent être très grands, assez spacieux pour laisser passer les calculs et les caillots de sang. Ces yeux tissés se trouvent dans une dépression ou cuvette qui en rend les bords absolument insensibles au toucher, car ils sont arrondis, bien gommés, tous les praticiens les réclament et les ont nommés yeux de velours. Ces yeux de velours sont une des créations faites par la Maison **DELAMOTTE** en 1840.

DELAMOTTE

Toutes nos Sondes **soie blonde, très souples** ainsi que nos autres Sondes, universellement connues, celles en **gomme blonde foncée, demi-souples** et celles en **gomme noire demi-rigides**, sont à **bouts pleins**, c'est-à-dire avec **yeux aseptiques**, elles sont terminées à l'autre extrémité par un **godet ou pavillon** qui, par sa forme cylindro-conique, peut recevoir la presque totalité de tous les embouts de seringues.

Par un nouveau procédé pneumatique, **nous gommons toutes nos Sondes à l'intérieur**. Ce procédé fait à chaud et par pression force la gomme à pénétrer dans l'épaisseur de notre tissu et par suite ne peut s'en détacher ; en séchant elle s'aplanit en une pellicule lisse et unie, qui nous permet de garantir que **nos Sondes supportent victorieusement toutes les stérilisations et que l'asepsie n'est plus un leurre**, les germes infectieux ne peuvent plus se loger, ni dans le cul-de-sac, ni dans la trame, le nettoyage de la Sonde est aussi parfait et aussi facile à faire à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc, plus d'infection vésicale à craindre.

Quant à la couverture de nos Sondes, elle est faite avec notre **gomme DELAMOTTE** qui, depuis 1789, est restée toujours la même, mais grâce à de grands approvisionnements, à des réserves bien conditionnées, et par

suite d'un repos prolongé, d'une clarification raisonnée, nous avons pu obtenir **une teinte plus blonde et une qualité plus souple**. Aussi nos Sondes en soie très blondes, très souples, sont elles aussi résistantes que celles faites en notre qualité si réputée. Nous pouvons garantir qu'elles se conservent sous tous les climats, dans les plus chauds sans qu'il soit besoin de les séparer par aucune poudre, elles ne se collent jamais entre elles, dans les plus froids, sans qu'il soit besoin de les tenir dans un endroit spécial elles ne s'écaillent pas, ne se fendillent pas, ne se rident pas, elles conservent toujours et partout leur souplesse et leur élasticité sans pareille, leur brillant éclatant, leur transparence limpide, tout en restant toujours et partout **inaltérables et stérilisables**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 671 | **Sonde cylindrique** noire | La pièce | » 80 |
| 672 | — — blonde | — | » 80 |
| 673 | — — blond clair, **tissu de soie** très souple | — | 1 55 |
| 674 | **Sonde droite**, trou au bout (*bec à bout coupé*) | La pièce | 1 25 |
| 675 | **Sonde trou au bout**, noire, 2 yeux latéraux, *pour Uréthrotome interne* | La pièce | 1 25 |
| 676 | — — blond clair, **tissu de soie** très souple | — | 2 » |
| 677 | **Sonde conique** noire | La pièce | 1 » |
| 678 | — — blonde foncée | — | 1 » |
| 679 | — — blond clair, **tissu de soie** très souple | — | 1 75 |
| 680 | **Sonde olivaire** noire | La pièce | 1 25 |
| 681 | — — blonde | — | 1 25 |
| 682 | — — blond clair, **tissu de soie** très souple | — | 2 » |

Cône allongé

Cône court

| | | | |
|---|---|---|---|
| 683 | **Sonde à grosse olive du Dr Delaissement**, blonde | La pièce | 1 50 |

L'olive en déplissant la muqueuse fait que cette Sonde n'occasionne pas de fausses routes elle permet de les éviter quand elles existent

| | | | |
|---|---|---|---|
| 684 | **Sonde à béquille de Mercier**, noire | La pièce | 1 25 |
| 685 | — — — blond foncé | — | 1 25 |
| 686 | — — — blond clair, **tissu de soie** très souple | — | 2 » |

687 **Sonde à béquille à extrémité olivaire** La pièce **2 25**

688 **Sonde à béquille à yeux multiples du Dr Bazy,** noire La pièce **2 50**

689 **Sonde bi-coudée de Mercier,** noire La pièce **1 50**
690 — — — blond clair, **tissu de soie** très souple — **2 50**

691 **Sonde conique avec raccord métallique,** pas de vis mâle se vissant sur la bougie Réf. 692 La pièce **2 25**

692 **Bougie filiforme, raccord métallique,** pas de vis femelle se raccordant avec la sonde Réf. 691 La pièce **1 75**

693 **Sonde conique du Dr Delefosse avec raccord caché,** pas de vis mâle La pièce **2 75**

*Modèles déposés sous le n° ... d*

Sur le tissu devant composer le cathéter il est vissé après avoir cousu une armature en métal avec pas de vis pouvant recevoir des filiformes préparés ad hoc (voir page 4) le raccord est alors recouvert d'un tissu très serré venant se gripper se mouler exactement sur les aspérités antérieures du raccord. Ces Sondes d'une grande solidité remplacent avantageusement les Sondes en métal à conducteur.

DELAMOTTE

694 **Bougie filiforme à raccord caché,** pas de vis femelle s'adaptant aux Sondes ci-dessus (Réf. 693) La pièce **2 25**

695 Les deux pièces réunies, Réf. 693 et 694 **5 »**

*Ces Sondes se font avec un ou deux yeux, lorsque celui-ci est unique il est beaucoup plus grand.*

696 **Sonde à extrémité filiforme longue de Legouest** (Cathétérisme à la suite), blonde — La pièce **3 »**

697 **Sonde dilatatrice de Lési,** blonde, pointe de 15 c/m — La pièce **3 »**

698 **Sonde coudée du Dr Hamonic,** à béquille aplatie pour le cathétérisme sur filiformes à ventre de poisson (Réf. 614) — La pièce **2 50**

699 **Sonde à béquille du Dr Albarran,** à ventre de poisson, blond clair, **tissu de soie** très souple, recommandé pour le cathétérisme des prostatiques — La pièce **2 50**

700 **Sonde courbe olivaire** noire ou blonde — La pièce **1 75**

701 **Sonde à grande courbure de Gély,** noire, dite des vieillards — La pièce **1 25**

702 **Sonde à ventre,** du nº 8 au nº 30 Charrière, noire — La pièce **1 75**

# Sondes pour Instillations

Longueur 32 c/m, avec petit godet pour se monter sur les seringues

703 **Instillateur du Prof. Guyon,** noir, du n° 6 au n° 30 Charrière . . . La pièce **1 25**
704 — — blond foncé . . . — **1 25**
705 — — **tissu de soie,** blond clair . . . — **2 »**

Chaque Instillateur est accompagné d'un petit mandrin avec lequel on pourra facilement déboucher le trou de la boule quand celui-ci vient à s'obstruer

706 **Instillateur du Prof. Guyon** (à boule aplatie), noir . . . La pièce **2 »**

707 **Instillateur coudé du Dr Tuffier,** pour instillations chez les prostatiques, gomme noire, n° 14 au n° 20 Charrière . . . La pièce **1 50**

708 **Instillateur de Pouchet,** à boule ovalaire, noir . . . La pièce **1 25**

709 **Instillateur vesical du Dr Janet,** noir . . . La pièce **1 50**

Cette Sonde est composée d'un gros pavillon olivaire se continuant par une fine sonde droite à bout coupé. Fixée à l'Instillateur rempli de liquide, cette Sonde est introduite directement dans le canal de la sonde qui a servi à faire le premier lavage. Son pavillon olivaire qui obstrue complètement celui de la sonde s'oppose au reflux de liquide qui est ainsi forcé de pénétrer en totalité dans la vessie.

710 **Sonde à jet récurrent du Dr Thévens,** du n° 15 au n° 30 . . . La pièce **1 50**

711 **Sonde drainée du Dr Desnos,** pour lavage de l'urèthre antérieur, du n° 16 au n° 30 . . . La pièce **2 »**

Les trous latéraux de drainage assez considérables et espacés permettent au liquide d'être chassé avec force et d'assurer l'évacuation des produits de sécrétion. Le liquide sortant par les orifices multiples soulève les plis et valvules de la muqueuse. La boule terminale a pour but de faire reconnaître l'entrée de la portion membraneuse qu'on ne doit pas dépasser.

712 **Sonde à béquille du Dr Desnos,** à extrémité en pomme d'arrosoir, du n° 16 au n° 30 Charrière . . . La pièce **1 50**

Cette Sonde est destinée au lavage de l'urèthre prostatique. Il arrive souvent que les sondes droites à boule perforée pénètrent difficilement et butent dans le cul-de-sac du bulbe. L'extrémité relevée de cette Sonde permet d'éviter cet écueil.

713 **Sonde de Pouchet,** percée en arrosoir, pour injections, du n° 10 au n° 30 Charrière . . . La pièce **1 50**

714 **Sonde à boule du Dr Lavaux** — La pièce **2 »**

Les cannelures pratiquées dans la boule assurent le retour du liquide

715 **Sonde en gomme blonde très souple,** drainée pour le lavage de l'urèthre (Blennorrhagie), du nº 12 au nº 30 — La pièce **1 25**

Voir Réf. 889

716 **Sonde à Instillations locales du Dr Tuffier,** du nº 16 au nº 30 — La pièce **1 75**

## Porte-Remède pour l'Urèthre (Modèle du Dr JANET)

717 **Porte-Remède pour l'Urèthre antérieur** — La pièce **1 75**

Permet d'introduire dans l'urètre antérieur des petits suppositoires en forme de cylindres percés au niveau d'une de leurs extrémités d'une cavité qui s'adapte sur le bout effilé de l'instrument.

## Sondes Vésicales à double courant en Gomme noire

| | | |
|---|---|---|
| Ces Sondes se font aussi pour **le Rectum** | Voir Réf. | 776 |
| — — **les Bestiaux** | — | 827 |
| — — **en caoutchouc** | — | 910 |

718 **Double courant cylindrique pour homme,** noire, du nº 15 au nº 30 Charrière — La pièce **3 »**

719 — — **femme,** — — — **2 50**

720 **Sonde à double courant olivaire,** noire, du nº 15 au nº 30 Charrière — La pièce **3 75**

721 **Sonde à double courant à béquille,** noire, du nº 15 au nº 30 Charrière — — **3 75**

722 **Canule en cristal du Dr Janet,** pour monter les Sondes dans les lavages de la vessie — — **» 20**

723 **Canule en cristal du Dr Janet**, pour les lavages directs de la verge, sans sonde. La pièce » **20**

724 **Canule en cristal du Dr Tuffier** La pièce » **75**

725 **Olive en gomme** servant d'embout aux seringues pour faire sans sonde les lavages La pièce » **60**

726 **Canules à lavages uréthro-vésicaux du Dr Hamonic** La pièce » **75**

Les Canules du Dr Hamonic, pour lavages uréthraux sans sonde, ont l'avantage une fois que la boule a pénétré dans la fosse naviculaire de se maintenir dans l'urèthre d'elles-mêmes et de laisser la liberté aux mains du malade, qui peut facilement régler la hauteur du flacon laveur et ouvrir ou fermer le robinet du tube qui conduit le liquide antiseptique.

## CONSERVATION DES INSTRUMENTS EN GOMME DELAMOTTE

*Tenez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité, de temps à autre les débarrasser de la poussière qui se dépose à leur surface et les frotter légèrement avec une peau de chamois ou un linge bien sec.*

---

On assouplit immédiatement une sonde ou bougie devenue trop rigide en la tenant un instant plongée dans l'eau tiède. On doit éviter de redresser ou courber une sonde chaude, du fait de la stérilisation; en attendant son refroidissement, elle reprendra d'elle-même sa courbure ou forme naturelle.

---

Les instruments de chirurgie en gomme portant la marque **DELAMOTTE**, sont les seuls garantis non collants et inaltérables sous toutes les latitudes; éviter de les mettre en contact avec ceux de fabrication inférieure qui les détériorent en s'y adhérant, ne les séparer par aucune poudre.

# Mandrins

727 **Bougie filiforme noire, double longueur,** servant de conducteur dans le cathétérisme par glissement (Procédé de Maisonneuve) La pièce **2 50**

728 **Bougie filiforme à ventre de poisson, du Dr Hamonic** La pièce **3 »**

729 **Mandrin urétéral du Dr Albarran** (Voir page 19) La pièce **5 »**

730 **Mandrin du Dr Janet,** 2 longueurs 32 et 40 c/m. La pièce **1 25**

Ce mandrin est destiné à rendre plus rigides les sondes Nélaton et à faciliter ainsi leur introduction. Avoir soin de graisser avant de l'introduire dans la sonde.

731 **Mandrin du Prof. Guyon,** avec presse-tige permettant de modifier la courbure des sondes pendant le cathétérisme. Indispensable pour l'introduction des sondes à demeure. *Indiquer la pointe préférée* La pièce **4 »**

732 **Mandrin droit en baleine,** avec presse-tige pour l'introduction des sondes à demeure La pièce **4 »**

733 **Mandrin en baleine,** tige cylindrique, 40 c/m de long, calibre nos 6 à 8 La pièce **2 »**

**Mandrins pour Sondes œsophagiennes** (Voir page 31)
— — **vétérinaires** (Voir page 31)

# Sondes Urétérales

## POUR LE CATHÉTÉRISME CYSTOSCOPIQUE DES REINS ET DES URÉTÈRES

## « MARQUE DORÉE » Tissu de soie

Toutes nos Sondes urétérales se font en gomme blonde sur tissu de soie, elles ont des parois aussi minces que possible pour donner un grand écoulement, elles sont d'une grande résistance, leur surface est lisse et unie.
Sur demande, nous pouvons modifier la forme de ces Sondes, augmenter le nombre d'ouvertures, les faire plus longues ou plus courtes, les graduer en dorure de centimètre en centimètre, les graduer en noir et blond, ces marques ineffaçables sont par centimètre, chaque dizaine a une remarque facilitant le repérage.

734 **Sondes cylindriques de 70 c/m,** *n^os 5-6-7 Charrière, un œil latéral, pouvant passer à frottement doux dans le conduit* ad hoc *des cystoscopes* . . . . . La pièce **2 75**

735 **Les mêmes,** avec le bout coupé . . . . . La pièce **2 75**

736 **Les mêmes,** avec le bout olivaire . . . . . La pièce **3 »**

737 **Graduation des Urétérales,** en plus par sonde . . . . . **» 50**

Dans un temps relativement très court, nous pouvons fournir ces trois modèles dans les n^os 5, 6, 7 et 8 et avec 1, 2, 3 ou 4 yeux latéraux.

738 **Mandrins du D^r Albarran** . . . . . La pièce **5 »**

Sur les indications du Prof. Albarran, nous avons construit des mandrins cylindriques de 70 c/m de longueur pouvant se raccorder ensemble par des pas de vis assez fins de façon que ces ajustages puissent passer facilement dans le conduit ad hoc de son cystoscope et dans les sondes à bout coupé des n^os 9 à 15. Ces mandrins, préparés sur de nouvelles données, sont souples sur toute leur longueur, tout en ayant assez de rigidité pour servir de bons conducteurs, ils remplacent avec succès les mandrins de baleine, ne s'effilent pas. Ils donnent une plus grande sécurité et un long usage.

739 **Sondes cylindriques de 70 c/m.** Du n^o 10 au n^o 14 Charrière, à bout coupé, avec godet pour faciliter les lavages . . . . . La pièce **2 75**

Se font avec 1, 2 ou 4 yeux, elles sont destinées à être introduites sur les mandrins ci-dessus.

740 **Les mêmes, sans godet** . . . . . La pièce **3 »**

La partie inférieure est arrondie pour coiffer les sondes N^os 734 à 736, elles sont destinées à être introduites par superposition d'arrière en avant.

741 **Les mêmes, avec le bout coupé en biseau,** pour les opérations plastiques de l'urétère et du bassinet . . . . . La pièce **3 »**

742 **Sondes cystoscopiques du D^r Frank,** pour instillations localisées dans les cystites rebelles, 33 c/m (Charrière n^o 7) . . . . . La pièce **2 »**

DELAMOTTE

# Bougies Œsophagiennes

## « MARQUE DORÉE »

Les numéros indiqués dans la désignation se rapportent aux numéros de la filière divisée par 1/3 de millimètre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 743 | **Bougie œsophagienne cylindrique noire,** du n° 1 au n° 30 Charrière | La pièce | **1 75** |
| 744 | — — du n° 21 au n° 40 — | — | **2 25** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 745 | **Bougie œsophagienne olivaire du Profr Bouchard,** noire du n° 1 au n° 30 Charrière | La pièce | **2 »** |
| 746 | — — — du n° 31 au n° 40 | — | **3 25** |
| 747 | — — — du n° 41 au n° 60 | — | **4 25** |

Les Bougies œsophagiennes peuvent être remplies de grenaille de plomb moyennant une augmentation de ... par pièce **» 60**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 748 | **Bougie œsophagienne à ventre,** noire, 7 à 10m/m de diamètre | La pièce | **2 25** |
| 749 | — — — — 11 à 14m/m | — | **3 50** |
| 750 | — — — — 15 à 20m/m | — | **4 50** |

751 **Bougie dilatatrice de Trousseau,** tige baleine et 6 olives en buffle ... La pièce **18 »**

# Sondes Œsophagiennes

## « MARQUE DORÉE »

Ces Sondes sont avec un œil tissé et travaillé le cul-de-sac est bouché, le pavillon est évasé en forme d'entonnoir

Se font avec 1 ou deux yeux depuis le nº 14 jusqu'au nº 60 (20 m/m), la longueur est d'environ 70 c/m. — Pour recevoir des Sondes plus courtes prière d'indiquer la longueur désirée.

752 **Sonde œsophagienne cylindrique noire,** nº 14 à 30 Charrière — La pièce 2 »
753 — — — nº 31 à 40 — — 2 25



754 **Sonde œsophagienne olivaire du Pr Bouchard,** noire, nº 6 à 30 Charrière — La pièce 2 50
755 — — — — — nº 31 à 40 — — 3 75
756 — — — — — nº 41 à 60 — — 4 75

757 **Mandrin en jonc poli** pour faciliter l'introduction de ces bougies ou de ces sondes — La pièce » 50
**Les mêmes, en baleine** — — 4 25

758 **Tubes œsophagiens en caoutchouc** (Voir page 40)

---

# Canules pour Trajets fistuleux, Nez et Oreilles

## en Gomme noire « MARQUE DORÉE »

759 **Canule du Dr Deleau** pour trajets fistuleux — La pièce 1 25

Se font dans les nº 3 à 6 de la filière et dans les longueurs de 8 à 25 c/m. Indépendamment du trou central, elles peuvent être munies d'ouvertures latérales.

760 **Canule du Dr Gellé,** du nº 10 au nº 15 Charrière, dans la longueur de 15 à 25 c/m — La pièce 1 »

761 **Canule à béquille d'Itard** pour la trompe d'Eustache — La pièce 1 »

762 **Filiforme olivaire** spéciale pour les canules ci-dessus, en gomme noire La pièce 1 »
763 — — — en baleine — 1 50

764 **Canule nasale de Piorry,** noire La pièce » 75

765 **Canule pharyngo-nasale du Dr Prietienne,** noire La pièce 1 25
Pour irrigations des fosses nasales en arrière

766 **Canule nasale noire** s'adaptant sur le tube des laveurs La pièce » 50

767 **Canule nasale du Dr Mourre,** noire La pièce » 50

768 **Tampon pour le massage** La pièce 2 »
5 grandeurs correspondant à des diamètres de 1, 2, 3, 4 et 5 centimètres

**Cornet acoustique,** 2 tailles
769 Grande taille, 16 c/m longr La pièce 4 »
770 Petite taille, 10 c/m longr — 3 »

771 **Bougies ou Sondes pour Sinus,** indiquer la longueur et la grosseur voulues

**Les mêmes, en caoutchouc** (Voir page 40)

# Dilatateurs du Rectum

## en Gomme noire « MARQUE DORÉE »

Le calibre de ces dilatateurs est indiqué par leur diamètre exprimé en millimètres.
A défaut d'indication les dilatateurs sont livrés avec trou au bout.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 772 | **Dilatateur cylindrique** noir, de 10 à 25 m/m de diam. | La pièce | 2 » |
| 773 | — — — 26 à 35 m/m — | — | 3 » |

774 **Dilatateur conique du Dr Gobillard**, noir, de 14 à 20 m/m de diam. ... La pièce **2 25**



775 **Dilatateur à ventre du Dr Strauss**, noir, de 14 à 26 m/m de diam. ... La pièce **2 50**




*Les tubes en caoutchouc* (Voir page 40)

## 776 Canule rectale drainée à double courant, du Dr Baraduc

**en Gomme noire**

Modèle déposé nº 10 185 — La pièce **3 »**

Permet de faire une irrigation continue et de laisser la muqueuse du rectum en contact avec le médicament aussi longtemps qu'on veut.

Cet effet est obtenu au moyen d'un tube d'entrée de l'eau qui doit irriguer le rectum sur une grande étendue, et d'un tube de sortie dont la lumière est placée dans le bas (A et B).

*Une notice détaillée accompagne chaque boîte*

# Canules pour Lavements

## en Gomme noire « MARQUE DORÉE »

777 **Canule forme conique**, 10 à 12 c/m ... La pièce » 27

778 **Canule forme ordinaire**, 8 c/m — » 25

779 **Canule pour enfant, fine**, 6 c/m — » 30

780 **Canule effilée**, petit entonnoir — » 50

781 **Canule effilée « olive**, petit entonnoir — » 50

782 **Canule effilée** à grand entonnoir, avec ou sans olive — » 50

### Canules droites avec ou sans olives, de 7 à 60 c/m

Les Canules ci après désignées sont avec pavillon large coiffant exactement la généralité des raccords elles se font de 8 à 60 centimetres de longueur dans la forme droite ou olivaire, elles sont livrées assorties de grosseur

783 **Canules droites avec ou sans olive**, 7 à 8 c/m La pièce » 35

784 **Canules droites avec ou sans olive**, de 10 à 60 c/m

| Longueur en c/m | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 et 45 | 50 | 55 et 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque | » 40 | » 45 | » 55 | » 65 | » 75 | » 85 | 1 » | 1 10 | 1 30 | 1 75 |



785 **Canules du Dr Reliquet** en gomme blonde souple, double tissu, de 20 à 30 c/m La pièce 1 50
786 — — — — de 35 à 50 c/m — 1 75

Les ... (Voir page 42) Voir Renvoi (Page 81).

# Canules pour Injections Vaginales

787 **Canule du Dr de Savignac,** noire — La pièce **2 »**

788 **Canule de Lachapelle** (percée de 12 trous) — La pièce **1 25**

789 **Canule droite,** forme ordinaire (1 à 7 trous) noire — La pièce **» 60**
789 *bis* — — — blonde — **» 75**

790 **Canule droite pour fillettes,** noire — La pièce **» 60**
791 — — blonde — **» 75**

792 **Canule Énéma,** petit modèle — La pièce **» 50**

793 **Canule courbe pour fillettes,** noire — La pièce **» 60**
794 — — blonde — **» 75**

795 **Canule courbe,** forme ordinaire, noire — La pièce **» 60**
796 — — blonde — **» 75**



(Voir page 47)

## Spéculums DELAMOTTE en Gomme noire « MARQUE DORÉE »

797 **Speculum à glace de Fergusson,** en 3 tailles

| No | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| | 30 | 35 | 40 m/m |

La pièce **3 »**

798 **Modèle du Dr Martineau** pour bains
La pièce **2 25**

799 **Modèle du Dr Gendron,** pour bains
La pièce **2 75**

# Bandages Herniaires

### Recouverts de Gomme « Marque ( DELAMOTTE »

### Inaltérable, Imperméable et Stérilisable

Ces Bandages sont des appareils à ressort tout comme ceux garnis de peau, mais ils se distinguent de ceux ci en ce sens que la garniture reçoit elle-même un certain nombre de couches d'un enduit plastique, qui a pour effet de rendre ces appareils **inaltérables à la chaleur aussi bien qu'imperméables à l'eau ou à l'humidité de la transpiration.** Ces qualités ont pour conséquences immédiates :



1° De permettre de conserver le bandage constamment propre en le lavant,

2° De maintenir intactes la force et la souplesse du ressort ainsi que l'élasticité de la pelote,

3° D'éviter les éruptions et démangeaisons qu'occasionne toujours le bandage garni de peau

4° L'imperméabilité de ce bandage le recommande pour la natation, l'hydrothérapie et les sports,

5° Sa résistance à la chaleur en fait le seul bandage utilisable dans les pays chauds, de même que sous les climats humides, et permet également de l'aseptiser par la chaleur sèche à 140° aussi bien que par les agents chimiques

6° Très longue durée d'usage sans se durcir ni se ramollir, d'où économie

Ces qualités les doivent faire préférer non seulement pour le bain, mais pour l'usage journalier, et les rendent indispensables pour les **sports**

RÉFÉRENCES. — **Approbation unanime du Corps médical.** Après expériences comparatives, la mise en usage des **Bandages DELAMOTTE** a été décidée dans tous les **Ministères français** et la plupart des **Grandes Administrations Françaises et Étrangères** qui les ont adoptés pour les besoins de leur personnel, attestant qu'ils réunissaient toutes les conditions de commodité, de bonne contention, de résistance à l'usage, ainsi que méticuleuse propreté

---

## Garniture des Pelotes en une nouvelle Matière

# « Le Plastico ( DELAMOTTE » (Déposé)

Sur les conseils de plusieurs Chirurgiens de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux de Paris, nous avons créé une nouvelle Garniture de Pelotes extra-souples que nous avons dénommée « **Plastico ( DELAMOTTE »** spécialement recommandée pour les enfants et les personnes sensibles

Nous conservons notre ancienne garniture de pelotes demi-souples et nous fournissons ainsi au choix de la clientèle et sur sa demande :

Pelotes demi-souples (**Ancienne garniture**)

Pelotes extra souples (**Garniture Plastico**)

### Garniture d'Appareils spéciaux

Les Bandages, quelle que soit leur origine peuvent etre recouverts de **Gomme DELAMOTTE**, un délai de douze à quinze jours est pour cela nécessaire.

N. B. — Les Bandages **DELAMOTTE** grâce à la forme circulaire du ressort, doivent se porter sans gêne, ni fatigue et se maintenir en place sans qu'il soit besoin de tendre fortement la courroie d'attache. Tout bandage qui ne répond pas à ces conditions doit etre échangé comme n'étant pas celui qui convient au cas du malade

800 **Bandage simple** — Ressort circulaire centre pour embrasser les dix douzièmes de la circonférence du bassin. — *Se mesure de A à B*

| Pelotes | | Poire, ronde corbin | Ana tomique | Crural |
|---|---|---|---|---|
| Pour enfant, de 28 à 45 c/m | La pièce | 3 25 | 3 65 | » |
| — cadet, de 46 à 65 c/m | — | 4 25 | 4 75 | » |
| — adulte, de 66 à 95 c/m | — | 5 » | 5 60 | 5 60 |
| — — de 96 à 105 c/m | — | 7 50 | 8 10 | 8 10 |

*Indiquer la forme des Pelotes, poire, ronde, corbin, anatomique ou crurale*

801 **Bandage double brisé** — Formé de deux ressorts demi-circulaires réunis par une courroie de dos. Les extrémités des ressorts élargies en queue d'hirondelle formant coussin — *Se mesure de A à B*

| Pelotes | | Poire, ronde corbin | Ana-tomique | Crural |
|---|---|---|---|---|
| Pour enfant, de 28 à 45 c/m | La pièce | 4 25 | 4 85 | » |
| — cadet, de 46 à 65 c/m | — | 6 » | 6 50 | » |
| — adulte, de 66 à 95 c/m | — | 7 50 | 8 10 | 8 10 |
| — — de 96 à 105 c/m | — | 9 50 | 5 10 | 8 10 |

*Indiquer la forme des Pelotes, poire, ronde, corbin, anatomique ou crurale.*

802 **Bandage double ou à lunette** — Ressort circulaire d'une seule pièce, modèle doux à porter, n'occasionne aucune gène sur la région lombaire grâce à la disposition du ressort — *Se mesure de A à B*

| Pelotes | | Poire, ronde corbin | Ana tomique | Crural |
|---|---|---|---|---|
| Pour enfant, de 28 à 45 c/m | La pièce | 4 75 | 5 15 | » |
| — cadet, de 46 à 65 c/m | — | 7 50 | 8 » | » |
| — adulte, de 66 à 95 c/m | — | 8 50 | 5 10 | » |
| — — de 96 à 105 c/m | — | 10 » | 10 80 | » |

*Indiquer la forme des Pelotes, poire, ronde, corbin ou anatomique.*

803 **Bandage anatomique.**

804 **Bandage crural**

Pour ces deux modèles,
voir leurs prix
dans les colonnes ci-dessus.

Voir Gestation des Pelotes page 30

805 **Bandage ombilical.** — Ressort circulaire avec pelote de forme ronde bien rembourrée formant bouton à son centre. *Se mesure de A à B*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pour enfant, | de 28 à 45 c/m | La pièce | 4 25 |
| — cadet, | de 46 à 65 c/m | — | 6 » |
| adulte | de 65 à 95 c/m | — | 7 50 |
| — | de 96 à 105 c/m | — | 8 50 |

806 **Sous-cuisse en mèche** avec une patte en cuir — — La pièce » 15

807 **Sous-cuisse en caoutchouc vulcanisé** avec passant et patte en cuir La pièce » 60

# Pelotes Gomme pour Bandages Herniaires

Sur le même principe que les pelotes fixées sur nos Bandages herniaires, nous avons créé et mis en magasin des pelotes en gomme de grandeurs courantes. Les pelotes dont l'écartement des vis est celui généralement employé, se montent facilement sur les ressorts à crémaillère et sur ceux à coulisse. Elles s'adaptent sur la plupart des Barrettes pour Bandages sans ressort, sur les ceintures de tissus élastiques, elles sont d'un très bel effet et sont fort appréciées aussi bien pour les appareils vendus bon marché que pour les appareils riches.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 808 | **Pelotes Poires,** nos 1 à 4 (voir page 30) | | La pièce | 1 40 |
| 809 | — | nos 5 à 8 | — | 2 10 |
| 810 | **Pelotes Corbin,** nos 1 à 5 | | — | 1 40 |
| 811 | — | nos 6 à 10 | — | 2 25 |
| 812 | **Pelotes Anatomiques,** nos 1 à 4 | | — | 1 80 |
| 813 | — | nos 5 à 8 | — | 2 75 |

*Voir Grandeur des Pelotes,* page 30

| | | | |
|---|---|---|---|
| 814 | **Pelotes rondes,** nos 1 à 4 (Voir grandeurs, page 30) | La pièce | 1 40 |
| 815 | — nos 5 à 7 — | — | 2 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 816 | **Pelotes Ombilicales rondes,** 4 à 6 c/m diamètre | La pièce | 1 80 |
| 817 | — — 7 à 13 c/m — | — | 2 75 |

Sur commande, nous pouvons faire rapidement des pelotes concaves pour hernie irréductible. Échancrée pour Ectopie testiculaire, et tous autres modèles.

Bien spécifier la grandeur des plaques, l'emplacement et le nombre des boutons ou noyaux, l'épaisseur a donner à la garniture.

De préférence nous adresser les plaques ou un dessin

## Nouvelle Barrette « Modèle déposé »

818 La seule permettant d'incliner à volonté chacune des pelotes, et de les rapprocher plus ou moins.
Une fois les pelotes mises en place et les vis serrées à fond, on peut avoir l'assurance que la position donnée aux pelotes est conservée.

La pièce . . . . . . . . . 2 25

**POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS**

**Exiger sur chaque instrument**

**La demi-lune à côté du nom DELAMOTTE**

**DELAMOTTE**

Marque déposée conformément aux lois

Les contrefacteurs seront rigoureusement poursuivis

# Grandeurs naturelles des Plaques de Bandages

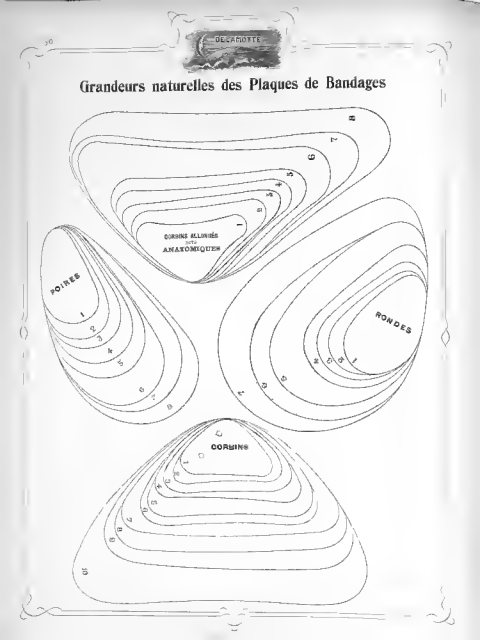

# Instruments Vétérinaires

**en Gomme noire, stérilisable et inaltérable sous tous les climats**

**« MARQUE DORÉE »**

## Sondes vésicales

820 **Pour chevaux,** longueur 1m10, diamètre 8m/m, 1 œil — La pièce **3 25**
821 — **juments,** — 1m10, — 10m/m, — — **3 25**
822 — **poulains,** — 0m70, — 6 à 8m/m — — **2 75**

Ces trois sortes peuvent servir pour l'œsophage des animaux de petite taille.

823 **Pour bœufs,** longueur 1m30, diamètre 18 à 20m/m, 1 œil — La pièce **5 25**

Ce modèle peut servir aussi pour refouler sans accidents les corps étrangers dans l'œsophage (*fruits, pommes de terre, etc.*)

824 **Pour chiens, moutons,** etc., longueur 0m35, diamètre 4 à 6m/m, 1 œil — La pièce **1 50**

## Sondes œsophagiennes

825 **Pour chevaux et animaux de grande taille,** long. 1m60, diam. 11 à 14m/m, 1 œil — La pièce **8 »**
— **animaux de petite taille,** voir Réf. 752 et 820

## Sondes utérines

826 **Pour vaches,** longueur 0m85, diamètre 20 à 22m/m — La pièce **5 »**

## Sondes utérines à double courant

827 **Pour vaches,** longueur 0m75, diamètre 20 à 30m/m, 2 yeux — La pièce **9 »**

828 **Mandrins en jonc verni ou ciré** pour donner une plus grande fermeté à ces Sondes — *Indiquer pour quelle référence* — La pièce **» 50**

Ces Sondes ont leur place indiquée chez les Propriétaires et Éleveurs à qui elles permettent dans les cas urgents de donner aux animaux les premiers soins en l'absence du vétérinaire. En ayant ces instruments à la main, on évite toute perte de temps et l'aggravation des accidents est arrêtée dès leur début. Ces Sondes ne sont expédiées que par colis postal, ne peuvent voyager par poste. Avoir soin lorsque la nécessité oblige de les courber, de les laisser se redresser d'elles-mêmes, en peu de temps elles reprennent leur forme première. Après usage, bien les rincer à l'eau froide et les conserver dans un endroit sec, accrochées et non pliées. Pour les aseptiser ne pas employer de solution à base d'alcool, les passer à l'étuve sèche à 100° pendant un quart d'heure ou les mettre en contact avec des vapeurs de Formol Trioxyméthylène.

# Boîtes à Sondes

829 **Boîte à Sondes** en bois de noyer ou citronnier, à cinq tiroirs — La pièce **31** »



830 **Boîte à Sondes** en bois blanc, à 5 cases — La pièce **3** »
831 — — à 10 cases — **4 50**

832 **Filière Charrière** métal, nº 1 à 30 — La pièce **2** »
833 — — carton — *Prix suivant quantités*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 834 | **Boîte Porte-Sondes** avec récipient pour vaseline | La pièce | 2 50 |
| 835 | — — perforé pour Trioxyméthylène-Formol | — | 2 50 |



Construite en métal nickelé cette boîte est d'un nettoyage facile, ses dimensions sont telles qu'elle se dissimule aisément dans la poche du vêtement la sonde s'y loge sans fatigue

# Tubes à Stérilisation

**Tubes en cristal** fermés par un bouchon de caoutchouc (*sans le récipient en métal*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 836 | Petit modèle, 20 m/m de diamètre, longueur 40 c/m | La pièce | 2 25 |
| 837 | Moyen — 30 — — — | — | 3 25 |
| 838 | Grand — 40 — — — | — | 4 » |

839 **Récipient en métal nickelé**, pour Trioxyméthylène s'adaptant aux bouchons de caoutchouc de nos tubes — Le récipient seul 1 »

840 **Pastilles de Formol** — La douzaine » 35

# Porte-Tubes sur pivot

Support monté sur planchette, se fixant au mur



841 **Grand Modèle,** 10 places . . . . . . . . Net. **80** »

Ces porte-tubes établis en métal nickelé, constituent de petits meubles élégants

Grâce au pivot, le praticien peut, sans déranger l'appareil, amener à la portée de sa main le tube qui lui est nécessaire.

Sauf indication, ces porte-tubes sont construits pour recevoir des tubes de 30m/m de diamètre



# Stérilisateur pour Sondes

## en Gomme

**Modèle du Dr Hamonic**

Le gaz aldéhyde formique étant reconnu comme le meilleur moyen de destruction des bacilles et microbes, sans détériorer les objets quels qu'ils soient, l'appareil créé par le Dr Hamonic, basé sur ce principe, se recommande tout spécialement pour la stérilisation des sondes creuses en gomme, celle-ci étant faite à froid et l'aldéhyde forcé de passer par l'intérieur des sondes, stérilise cet intérieur, ce qu'on n'était pas arrivé à faire jusqu'à ce jour

Malgré cela, toute pièce ou objet de pansement que peut contenir l'appareil est stérilisé d'une façon aussi parfaite, très rapidement, économiquement, sans dégager aucune odeur à l'extérieur, et ne demandant pas de connaissances spéciales de la part de l'opérateur

Prix de l'appareil . . . . . . . . Net **80** »

**Une notice explicative accompagne chaque appareil**

*Les instruments en gomme élastique portant la Marque* « DELAMOTTE » *sont les seuls garantis* **stérilisables à 120° et par tous les antiseptiques (préparés sans alcool)**

# Renseignements et Recommandations

## sur les différents modes de stérilisation des Instruments en Gomme élastique et en Caoutchouc

I

## NETTOYAGE

Le nettoyage des Instruments est aussi nécessaire que leur stérilisation et doit *toujours* la précéder. Avant d'être stérilisées, les sondes devront être rigoureusement *nettoyées, essuyées et séchées*, de même pour tous les instruments, quels qu'ils soient. Ce nettoyage se fera avec l'eau savonneuse tiède, par frictions extérieures, et par injections dans les instruments creux; on rincera ensuite, puis on essuiera et on séchera soigneusement les instruments dès lors prêts pour une stérilisation efficace.

II

## STÉRILISATION

La stérilisation comporte deux sortes de procédés :

*Agents physiques* (chaleur sèche ou humide);

*Agents chimiques* (antiseptiques divers).

**1° Chaleur sèche.** — Les appareils employés sont l'étuve à stérilisation, ou le four à flamber de Pasteur. On chauffera à 120° pendant 15 minutes ou bien à 3 reprises à 100°, ce chauffage discontinu étant plus long et ménageant davantage les sondes.

**2° Chaleur humide.** — *A. Eau bouillante à 100°.* Moyen bon, pratique et suffisant, pour les instruments en caoutchouc que 5 minutes d'ébullition stérilisent.

*B. Vapeur d'eau bouillante à 100°.* Procédé peu employé.

*C. Autoclave* 115 à 120° pendant un quart d'heure suffit.

L'autoclave permet de stériliser le caoutchouc et le métal. Contre l'humidité, avoir soin d'entourer les instruments de papier à filtrer.

**3° Antiseptiques liquides.** — Leur emploi est simple et souvent suffisant. L'immersion continue altère assez vite les sondes, l'immersion discontinue suffit, à condition de plonger la sonde (primitivement nettoyée et savonnée comme toujours) dans le bain antiseptique pendant une heure ou deux avant de s'en servir. Les sondes DELAMOTTE résistent longtemps à cette stérilisation. Les antiseptiques liquides à conseiller sont, par ordre de préférence : les solutions de nitrate d'argent à 1 p. 1000, de biiodure de mercure à 25 p. 1000, de bichlorure à 1 p. 1000. Au besoin, pour les urèthres sensibles, passer la sonde dans l'eau boriquée avant de l'introduire, pour enlever l'antiseptique fort, un peu irritant pour la muqueuse. *Quelle que soit la solution antiseptique employée, elle ne doit dans aucun cas être préparée à l'alcool, car celui-ci dissout les gommes.*

**4° Antiseptiques gazeux.** — *A. Acide sulfureux.* C'est un assez bon procédé de stérilisation, mais nous ne ferons que le mentionner car il doit, aujourd'hui, céder le pas au formol.

*B. Formol et trioxyméthylène.* La solution commerciale de formol et son Polymère soluble, le trioxyméthylène, sont les antiseptiques gazeux les meilleurs pour la stérilisation des Sondes et, en général, de tous nos instruments : les sondes DELAMOTTE supportent admirablement bien un grand nombre de stérilisations successives par ces agents antiseptiques, dont l'emploi est fort simple. Voici, rapidement exposée, la façon de procéder : placer les sondes, nettoyées et séchées, sur une tablette à jour ou une toile située au milieu d'une caisse métallique fermée et au fond de laquelle on répandra soit la solution de formol à 40 °/₀, soit la poudre de

trioxyméthylène, les vapeurs qui se dégagent suffisent pour assurer la stérilisation des sondes en 24 heures en moyenne. Le trioxyméthylène est un peu supérieur au formol, car il agit à sec et ne ramollit pas les sondes, mais son action est moins rapide. Pour stériliser un grand nombre d'instruments, dans une grande caisse, c'est au formol qu'on donnera la préférence, réservant le trioxyméthylène pour les petites caisses et un nombre restreint d'instruments; 24 heures suffisent pour les sondes et bougies ordinaires, 48 heures pour les instruments fins à calibre intérieur très petit, les boîtes seront maintenues à la température ordinaire des appartements, pas au-dessous de 10°. Avant d'employer les instruments, il sera bon de les passer dans une solution boriquée pour qu'ils ne soient point irritants.

M. le Dr J. Albarran, utilisant la propriété qu'ont les antiseptiques d'agir plus rapidement et plus activement à chaud qu'à froid et celle de l'alcool méthylique qui produit l'aldéhyde formique sous l'influence du platine incandescent, a fait construire une *étuve thermo-formogène* qui permet de stériliser rapidement et sûrement (en une demi-heure), tous les instruments de chirurgie.

A recommander aussi, les procédés du Dr Claudius, de Copenhague, du D. Chaput, d'Angers, qui emploient des solutions de chlorure de sodium à 110°.

L'appareil du Dr Hamonic est aussi d'un emploi facile, il permet d'aseptiser rapidement des quantités de sondes, avec économie sans les abîmer. (Voir page 34)

5° **Glycérine**. — Placer les sondes dans des tubes de verre non bouchés et contenant de la glycérine pure à 30°, mettre ceux-ci perpendiculairement dans un vase assez haut contenant de l'eau que l'on fera bouillir pendant 30 minutes, fermer alors les tubes avec un bouchon stérilisé à l'eau bouillante, prendre, au fur et à mesure, avec une pince flambée. Wolff a constaté que le séjour des sondes, pendant 24 heures, dans la glycérine contenant 3% de formaline les stérilisait; cette stérilisation s'obtient au bout d'une heure si on soumet cette même glycérine pendant ce temps à l'action de la vapeur à 100°, on peut conserver les sondes dans ce milieu antiseptique, en les passant à l'eau boriquée avant de s'en servir. Les sondes DELAMOTTE supportent bien ces modes de stérilisation et se conservent en parfait état dans les tubes de glycérine.

## GRAISSAGE DES INSTRUMENTS

N'employer que des substances aseptiques ou antiseptiques en évitant qu'elles ne soient irritantes : huiles d'amandes douces, vaseline boriquée, vaseline salolée, huile phéniquée au 20e, glycérine stérilisée, mieux vaut la pommade suivante, dont la formule est due au Dr J. Janet :

| | |
|---|---|
| Lanoline | 20 grammes, |
| Huile de vaseline | 10 — |
| Borate de soude | 1 gr. 60. |

Mieux vaut encore la pommade ou enduit soluble qui permet un meilleur nettoyage des instruments :

| | |
|---|---|
| Poudre de savon | } ââ 33 grammes. |
| Glycérine | |
| Eau | |
| Phénol absolu ou Naphtol B | 1 gramme. |

F. Guyon.

---

*Les instruments de mauvaise fabrication ne peuvent être stérilisés.*

*Sous l'action de la chaleur ils se dissolvent ou deviennent cassants.*

*La stérilisation par les agents chimiques est pour eux illusoire, insuffisante, les germes trouvant un abri dans les fissures, éraillures que présente leur surface.*

*Seuls les instruments « Marque DELAMOTTE » doivent à leur résistance à la chaleur, à la parfaite adhérence de la gomme au tissu, de pouvoir être stérilisés.*

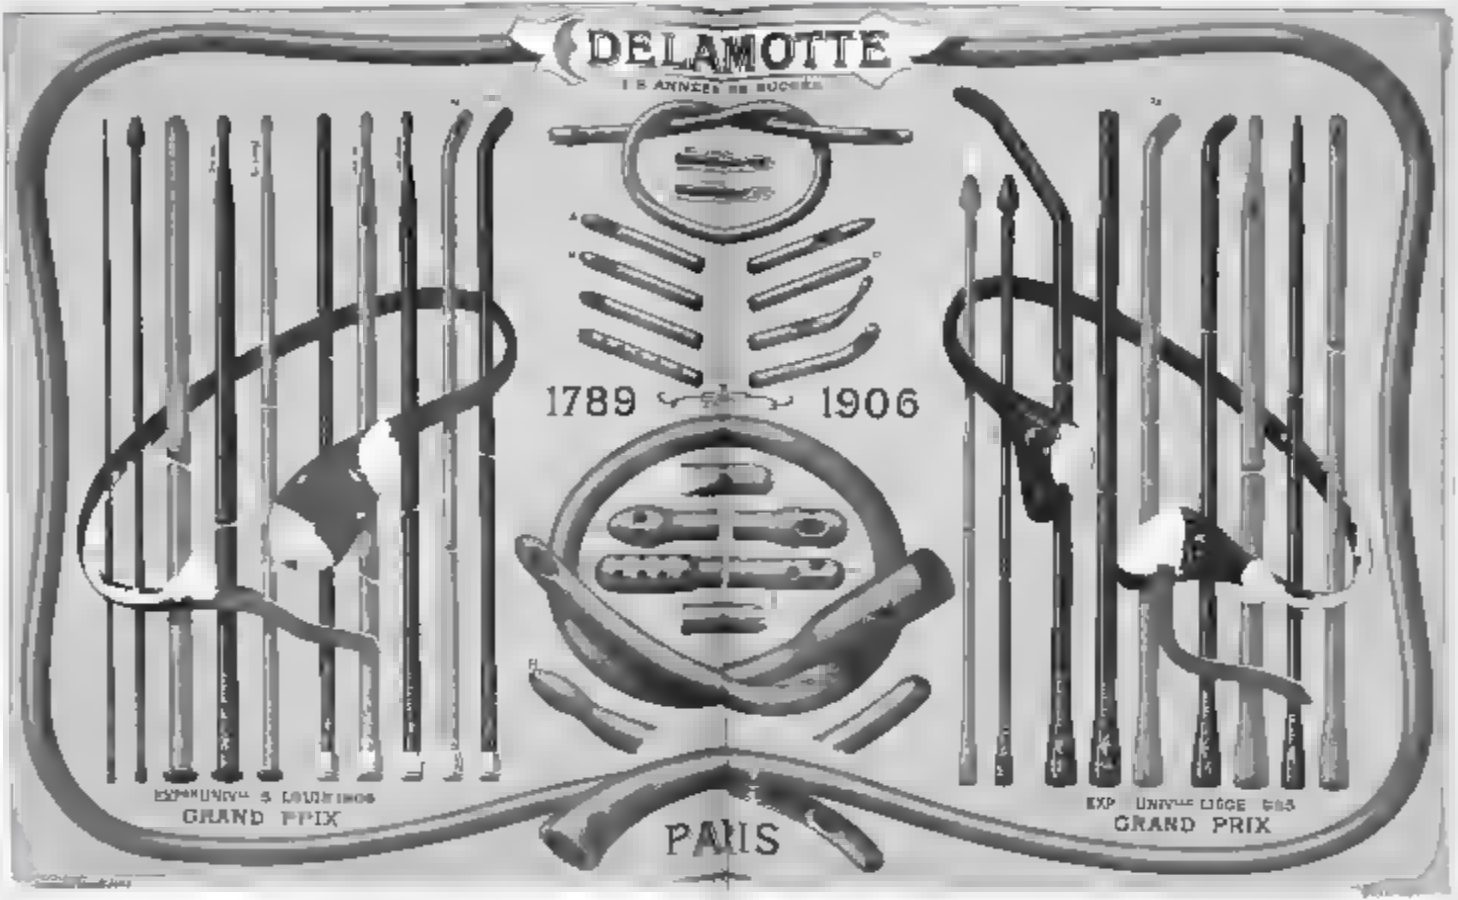
DELAMOTTE
1789
1906
GRAND PRIX
GRAND PRIX
PARIS

# Instruments en Caoutchouc rouge moulé

Les Instruments de Chirurgie en caoutchouc rouge moulé (Sondes Nélaton, sondes œsophagiennes, canules rectales et vaginales) portant la marque DELAMOTTE sont [illegible] préparés exclusivement avec les caoutchoucs Para 1re qualité, et vulcanisés avec la quantité de soufre [illegible] nécessaire à leur cuisson. Ne contenant aucune matière étrangère, ils conservent leur surface lisse, glacée et restent souples.

Les sondes en caoutchouc de Nélaton livrées avec la marque DELAMOTTE en caractères imprimés sur chaque instrument sont absolument inoffensives pour les muqueuses.

De préférence, les placer dans un endroit sombre, aéré et humide, éviter le sec et le chaud.

L'air libre et la poussière provoquent quelquefois un léger blanchiment de la surface, on le supprime moyennant une légère friction avec de la glycérine.

**Tous les prix des Articles de caoutchouc sont variables suivant les cours de la matière première**
**Ils peuvent être modifiés sans avis préalable**

## Sondes vésicales de Nélaton

**Sondes vésicales de Nélaton, sans godet.**

| | | | Nos 8 à 21 | 22 à 24 | 25 à 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | **32 c m**, œil moulé aseptique ou non | La pièce | » 45 | » 70 | » 95 |
| 861 | **40 c m** — — | — | » 50 | » 75 | 1 » |

**Sondes vésicales de Nélaton, avec godet**

| | | | Nos 8 à 21 | 22 à 24 | 25 à 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | **32 c/m**, œil moulé aseptique ou non | La pièce | » 50 | » 75 | 1 » |
| 863 | **40 c/m**, — — | — | » 60 | » 85 | 1 25 |




**Indiquer la pointe préférée : A, B, C, D**



| | | | N° 8 à 12 | 22 à 24 | 25 à 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Sonde Nelaton [illegible] | La pièce | » 75 | 1 » | 1 35 |
| [illegible] | Sonde prostatique à béquille de Mercier, 40 c/m | La pièce | 1 » | 1 25 | 1 50 |
| [illegible] | Sonde prostatique à béquille et à extrémité olive, 40 c/m | La pièce | 1 25 | 1 50 | 1 75 |

| | | | N° 8 à 21 | 22 à 24 | 25 à 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | **Bougie de Nelaton,** sans yeux et sans rodet, 32 c/m | La pièce | » 45 | » 70 | » 95 |
| 868 | **Les mêmes,** remplies de grenaille de plomb, **du Dr Baar** | — | » 65 | » 95 | 1 25 |
| 891 | **Sonde uréthrale en caoutchouc moulé** (parois minces percée de nombreux trous pr la blennorrhagie), 25 c/m, du n° 14 au 26 | — | » 75 | 1 » | 1 25 |

## Nouvelle Sonde à demeure, de Malécot (Modèle à ailettes)

Modifiée selon les indications du Prof. Albarran

Les sondes molles destinées à être mises à demeure présentent à leur extrémité soit un renflement en forme de disque (sonde de D. Pezzer) soit des ailerons (sonde du D. Malécot). Ces dernières paraissent préférables car les ailerons tout en maintenant aussi solidement la sonde au niveau du col vésical en rendent l'introduction et l'enlèvement plus faciles.

L'inconvénient de ces sondes consistait dans la rupture fréquente des ailerons de traction A qui, soudés par le milieu, n'avaient qu'une solidité très relative (fig. 1). Les fabricants n'ayant pas réussi à vaincre les difficultés techniques permettant d'obtenir des ailerons d'une seule pièce, cette rupture était suivie de l'allongement immédiat des ailerons soudés B et la sonde n'était plus fixée.

Le Prof. Albarran a remédié à [illegible] en nous faisant construire les ailerons de traction A d'une seule pièce (fig. 2). [illegible] la rupture n'est plus à craindre et les sondes ainsi fabriquées présentent les plus grandes facilités d'introduction [illegible] solidité parfaite qui assure leur maintien [illegible] et leur bon fonctionnement.

Fig. 1

Fig. 2

Modèle déposé [illegible]

| | | | N° 8 à 21 | 22 à 24 | 25 à 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Cette sonde [illegible] à 2 ailettes | La pièce | 2 50 | 2 60 | 2 75 |
| [illegible] | Les mêmes sondes avec 4 ailettes | — | 3 » | 3 10 | 3 25 |

Modèle déposé [illegible]

Voir **Mandrins,** page 18

Voir **Drains,** page 50



872 **Sonde à demeure du Dr de Pezzer,** [illegible] La pièce **2 75**

873 **Rallonges en caoutchouc** pour sondes en gomme et pour sondes à demeure La pièce **1 25**

874 **Tube double en caoutchouc moulé** pour le drainage de la vessie. Modèles des Prof. Guyon et Perrier La pièce **4 50**

Ces tubes moulés sont plus fermes que ceux en feuille anglaise. Ils ne sont pas sujets à s'aplatir. **Maximum d'écoulement.**

Mod. [illegible] sous le nº [illegible]

875 **Fixateur pour Sondes,** en feuille anglaise
La pièce [illegible] 60

876 **Canules en caoutchouc du Dr Kutner,** pour lavages urétraux [illegible] 3 yeux, nº 12 à 15 Charrière La pièce [illegible] 50

877 **Sonde à double courant,** pour lavages de la vessie, 35 c/m, du nº 22 à 30 avec 2 raccords cristal La pièce **3 50**

*Les [illegible] Ref. 910*

Les Instruments de Chirurgie en caoutchouc rouge moulé (**Sondes Nélaton, Sondes œsophagiennes, Canules rectales et vaginales**) portant la marque « **DELAMOTTE** » sont garantis préparés exclusivement avec des caoutchoucs **Para 1re qualité** et vulcanisés avec la quantité de soufre strictement nécessaire à leur cuisson. Ne contenant aucune matière étrangère, ils conservent leur surface lisse et glacée et restent souples.

*De préférence les placer dans un endroit sombre, aéré et humide, éviter le [illegible] et le chaud. [illegible] et la poussière [illegible] quelquefois un léger blanchiment de la surface; on le supprime moyennant une légère friction avec de la glycérine.*

# Sondes Œsophagiennes en Caoutchouc moulé

## Tube pour le lavage de l'estomac

du Tube du Dr Faucher

Le caoutchouc moulé rouge, ne contenant que du Para 1re qualité vulcanisé avec la quantité de soufre strictement nécessaire. Longue conservation, surface lisse donnant une grande facilité d'introduction. Glaçage parfait, inaltérable, sans vernis d'une innocuité absolue pour les muqueuses. La paroi mince assure un grand débit et assez de résistance pour éviter que le tube ne s'aplatisse.

**4 Grosseurs**

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 | 10 | 12 | 14m/m |

*Indiquer Percement L ou K.*

878 **Tube à lavage en caoutchouc moulé,** godet de 20cm, en boîte carton.

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| La pièce | 5 » | 5 50 | 6 » | 6 » |

879 **Les mêmes,** avec balle aspiratrice, en boîte carton.

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| La pièce | 7 50 | 8 » | 6 50 | 10 50 |

Ces deux modèles avec tulipe en cristal et boîte carton, en sus 1 25

880 **Tube à lavage du Dr Debove,** 2 parties moulées réunies par un double raccord à vis en métal nickelé.

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| La pièce | 6 50 | 7 » | 7 50 | 6 50 |

881 **Tube à lavage du Dr Deléage,** graduation indélébile, rondelle d'arrêt, pointe E ou K.

| Numéros | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| La pièce | 6 » | 6 50 | 7 » |

882 **Tube à lavage du Dr Prémont,** [illegible]




| Numéros | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| La pièce | 8 » | 8 50 | 9 » |

883 **Tube à lavage du Dr Ozer,** 1m,50 chaque extrémité, pointe G

| Numéros | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| La pièce | 5 » | 5 50 | 6 » |

884 **Nouveau tube à lavage** avec grand entonnoir en caoutchouc moulé de 80m/m d'ouverture ; cet entonnoir est assez souple pour pouvoir se mettre dans la poche et assez résistant pour contenir le liquide. Indiquer pertinemment E ou K.

| Numéros | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| La pièce | 7 » | 7 50 | 8 » |

885 **Le même,** avec balle aspiratrice, en boîte en carton

| Numéros | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| La pièce | 8 50 | 10 » | 10 50 |

886 **Sondes œsophagiennes,** caoutchouc moulé sans godet, longr 55 c/m, 6 à 10m/m diam. La pièce 2 25
887 — — — — 75 — 6 à 12 — — — 3 25



888 **Sondes œsophagiennes,** caoutchouc moulé sans godet, long. 80 c/m [illegible] diam. La pièce 3 25

[illegible]

889 **Appareil à lavage, de Tarnier,** pour [illegible] gradué, sonde de 25 c m, 5m/m de diam., en boîte carton [illegible] La pièce 3 »
890 **Laveur du Dr Guinon,** pour l'estomac ou l'intestin [illegible] gradué 200 grammes, tubes et canules raccordés — 7 »

891 **Entonnoir en cristal** forme tulipe, pour les tubes œsophagiens — 1 25
892 — **caoutchouc moulé** — — 2 »
893 — **métal nickelé** — — 6 »

894 **Pinces** p...  La pièce » 50

895 **Balle aspiratrice** p. tubes à lavage  La pièce 2 50
**Raccords** pour tubes à lavage (Voir pag. 51)  — » 20

## Specimens de nos percements et des pointes pour nos sondes et canules en caoutchouc

# Canules pour lavement, caoutchouc moulé rouge

La grosseur des canules n'est pas garantie à 1/2mm près

896 **Canule Baby**  La pièce » 40

897 **Canule effilée pour enfant**  — » 35

898 **Canule conique pour enfant**  — » 35

899 **Canules forme droite** sans gode, pointe G

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en cm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Prix à pièce | » 45 | » 60 | » 75 | » 90 | 1 05 | 1 20 |






900 **Canules forme droite,** petit godet [illegible]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en c/m | 8 | 12 | 16 | [illegible] | [illegible] | 40 |
| Grosseur | Fine | Fine | Moyenne | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Prix, la pièce | » 40 | » 60 | » 50 | » 70 | 1 05 | 1 35 |

901 **Canules,** grand godet Indiquer pointe G, H, I, K, M, N

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en c/m. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Prix, la pièce | » 55 | » 75 | » 85 | » 95 | 1 10 | 1 25 | 1 50 | 1 75 | 2 » | 2 25 | 2 50 | 3 » |

902 **Canule du Dr Combes,** de Lausanne Longueur 1m 7 à 8m/m, percement E — La pièce **4 50**

## Canule intestinale à courants alternatifs, dite de Bagnères-de-Bigorre

DESCRIPTION

Cette canule permet le lavage complet du gros intestin par l'introduction et l'évacuation successives de faibles quantités de liquide sans retirer la sonde et sans déplacer le malade

Elle répond à l'un des plus graves reproches encourus par la méthode des lavages intestinaux en supprimant la possibilité de distension du colon et sera appréciée par les personnes atteintes d'hémorroïdes, de fissures, d'états inflammatoires quelconques de l'anus ou du rectum et qui supportent mal les manœuvres répétées d'introduction et d'extraction de la sonde (Dr Rozier, *la système abdominale*). Son emploi est indiqué dans les toxémies par rétention fécale, dans les états inflammatoires du petit bassin, les entérocolites, rectites, etc

| | | | |
|---|---|---|---|
| 903 | **Le raccord en étain** | La pièce | **1 25** |
| 904 | **La canule caoutchouc,** 30 c/m | — | **1 50** |
| 905 | **La paire de pinces** | — | **1 »** |
| 906 | **La canule complète,** en boîte carton avec notice | — | **3 75** |

Longueur 30 c m

# Nouvelle Sonde intestinale « Iléo-Pelvienne »

**pour irrigation simple, ou pour irrigation à double courant reversible**

Modèle déposé sous le nº 21 394

Cette nouvelle sonde rend simple et facile le lavage intestinal à courant continu, elle est d'une seule pièce en caoutchouc rouge Pur Para.

Introduite dans l'intestin jusqu'en C, l'eau entrant par AD, elle est à simple courant.

Introduite dans l'intestin jusqu'en B, l'eau entrant par AD, revenant par ER, elle est à double courant [illegible]. Mais l'eau entrant par RE ressortant par DA, elle est à double courant ascendant.

Cette sonde est d'un emploi facile, ne demande aucun aide pour son emploi, elle est meilleur marché [illegible] les canules compliquées, elle est indispensable pour le traitement de la constipation, entérites [illegible], auto-intoxications et fermentations intestinales, décongestion des organes du petit bassin, [illegible]

*[illegible] deux mètres de [illegible] avec volve [illegible] et 2 raccords en cristal*



| | | | |
|---|---|---|---|
| 907 | Nº 1, longueur [illegible] m | La pièce | 4 » |
| 908 | Nº 2 — [illegible] | — | 5 » |

# Canule Recto-Syphoïde à double courant, du Dr P. F.

Modèle déposé

Cette canule, en caoutchouc rouge souple, réalise au moyen d'une **disposition nouvelle**, les avantages suivants

1° Usage commode **sans se dévêtir** (assis sur un W. C. ou sur un Seau hygiénique), l'appareil étant construit pour fonctionner **verticalement**,

2° **Disque d'arrêt** limitant **automatiquement** l'introduction de la canule au siège des organes enflammés (Rectites, Prostatites, Metrites, etc.)

3° Balnéation efficace et complète **sur toute la longueur** de l'ampoule rectale, grâce aux orifices **opposés** d'arrivée et de sortie du liquide,

4° Action exclusivement **locale** et **limitée** mathématiquement à la hauteur de la canule dont les larges orifices, situés à la partie supérieure, évacuent aussitôt le liquide en excès et les gaz de l'intestin, par conséquent, **pas de coliques ni de besoin de défécation**

Spécialement efficace pour le **TRAITEMENT DES HÉMORROÏDES** et pour certaines manifestations intestinales de la **Tuberculose,** où une balnéation prolongée et sans fatigue pour le malade est prescrite (Congrès de la Tuberculose, 1905)

*Une notice explicative est jointe à chaque appareil*




909 Boîte marquée avec notice explicative 7 »

# Canule intestinale à double courant

910 Caoutchouc moulé 35 c m, ... de diam avec raccords cristal La pièce 4 »




# Nouvelles Sondes intestinales, dites « Châtelguyon »

du Dr Michel Cohendy — Modèles déposés sous le n° 11.917

Ces sondes pour enfants et adultes sont en caoutchouc rouge pur Para souple et ferme, stérilisable et de bonne conservation.

Ces sondes répondent à tous les besoins de l'irrigation intestinale de la médecine nouvelle; elles ont été établies sur des données anatomiques et physiologiques rigoureuses. Leur but est de parer aux inconvénients reconnus de certains modèles.

Ces sondes sont au nombre de trois.

1111 N° 1. **Sonde sigmoïde 40 c m,** pour irrigation simple à pénétration moyenne soit 1/3 de la longueur du gros intestin, c'est la sonde du lavement ordinaire. Les traits noirs indélébiles marqués sur chaque sonde indiquent la longueur à utiliser pour les enfants et les adultes.

La boîte n° 1, marquée **4** fr. net **3** »

1112 N° 2. **Sonde médio-colique 1m10,** pour irrigation simple à pénétration profonde, soit 2/3 de la longueur du gros intestin. Les traits noirs marqués sur chaque sonde indiquent la longueur à utiliser pour les enfants et les adultes; de plus, pour faciliter le repérage en cas d'ordonnances spéciales, les longueurs 30, 40, 70 c/m sont marquées par une petite bouteille renversée portant ces mêmes numéros.

La boîte n° 2, marquée **8** fr. net **8** »

1113 N° 3. **Sonde bi-courant,** pour irrigation continue. Cette sonde très ingénieuse sert de conducteur au n° 1 et au n° 2 qui la traversent; le dessin indique suffisamment l'arrivée et le retour du liquide. En dehors du traitement intestinal, cette sonde permet d'abaisser rapidement, par l'irrigation froide, la température des hyperthermiques.

La boîte n° 3, marquée **6** fr. net **4 50**

1114 **La Sonde sigmoïde** et la **Sonde bi-courant réunies.**

La boîte n° 4, marquée **10** fr. net **7 50**

DELAMOTTE

# Dilatateurs du Rectum

## en Caoutchouc moulé rouge

Le calibre de ces dilatateurs est indiqué par leur diamètre exprimé en millimètres [illegible], ils sont toujours livrés avec trou au bout

| | | Grosseur en millimètres | 10 à 15 | 16 à 20 | 21 à 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | **Dilatateur cylindrique,** longueur 20 c/m. | La pièce | **1 50** | **2 50** | **3 75** |

| | | Grosseur en millimètres | 10 à 15 | 16 à 20 | 21 à 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | **Dilatateur conique,** longueur 20 c/m. | La pièce | **1 50** | **2 50** | **3 75** |

[illegible]

# Canules pour Injections vaginales

## Canules sans godet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 917 | **Canule 12 c/m,** | forme droite | La pièce | » 50 |
| 918 | — | gros modèle | — | » 70 |
| 919 | — **20 c/m,** | — | — | » 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 920 | **Canule 12 c/m,** | for[illegible] | La pièce | » 50 |
| 921 | — **16 c/m,** | — | — | » 60 |
| 922 | — **20 c/m,** | — | — | » 80 |

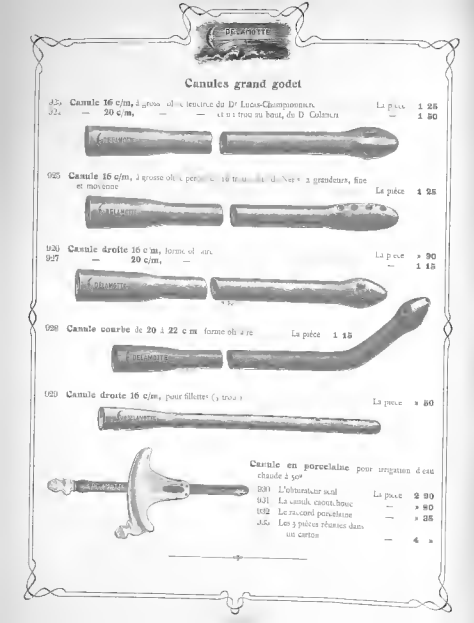


## Canules grand godet

923 **Canule 16 c/m,** à grosse olive lenticulaire du Dr Lucas-Championnière — La pièce **1 25**
924 — **20 c/m,** — — et un trou au bout, du Dr Colatrell — **1 50**

925 **Canule 16 c/m,** à grosse olive percée de 16 trous, du Dr Ners, 2 grandeurs, fine et moyenne — La pièce **1 25**

926 **Canule droite 16 c/m,** forme olivaire — La pièce **» 90**
927 — **20 c/m,** — — **1 15**

928 **Canule courbe de 20 à 22 c/m** forme olivaire — La pièce **1 15**

929 **Canule droite 16 c/m,** pour fillettes (3 trous) — La pièce **» 80**

**Canule en porcelaine** pour irrigation d'eau chaude à 50°

| | | | |
|---|---|---|---|
| 930 | L'obturateur seul | La pièce | **2 90** |
| 931 | La canule caoutchouc | — | **» 90** |
| 932 | Le raccord porcelaine | — | **» 35** |
| 933 | Les 3 pièces réunies dans un carton | — | **4 »** |

# Canules pour le Nez et les Oreilles

## en Caoutchouc moulé rouge

934 **Canule à béquille d'Itard,** pour la trompe d'Eustache . . . . . La pièce 75

935 **Canule à béquille** pour le lavage [illegible] . . . . . La pièce » 75

Le [illegible] page [illegible]

936 **Canule olivaire du Dr Gellé,** pour insufflation d'air, longueur [illegible] sans godet . . . . . La pièce 1 60

937 **Sinus en caoutchouc,** modèles variés (indiquer longueur et grosseur et de préférence envoyer dessin). — *Prix suivant modèles*

[illegible]

Les Instruments de Chirurgie en caoutchouc rouge moulé (**Sondes Nélaton, Sondes œsophagiennes, Canules rectales et vaginales**) portant la marque « **DELAMOTTE** » sont garantis préparés exclusivement avec des caoutchoucs **Para 1re qualité** et vulcanisés avec la quantité de soufre strictement nécessaire à leur cuisson. Ne contenant aucune matière étrangère, ils conservent leur surface lisse et glacée et restent souples.

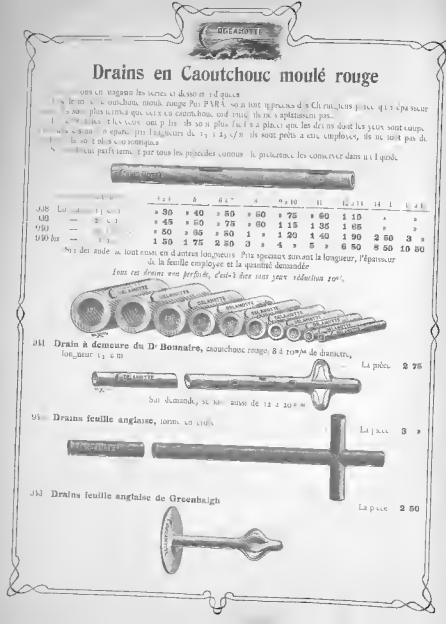

DELAMOTTE

# Drains en Caoutchouc moulé rouge

[illegible] ons en magasin les séries ci-dessous [illegible]

[illegible] caoutchouc moulé rouge Pur PARA sont tout appréciés des Chirurgiens parce qu'à épaisseur [illegible] sont plus fermes que ceux en caoutchouc ordinaire, ils ne s'aplatissent pas.

[illegible] plus faciles à placer que les drains dont les yeux sont coupés [illegible] par longueurs de 1 à 25 c/m ils sont prêts à être employés, ils ne font pas de [illegible] sont plus économiques.

[illegible] parfaitement par tous les procédés connus [illegible] les conserver dans un liquide.

| | | [illegible] | 5 | 6 à 7 | 8 | 9 à 10 | 11 | 12 à 13 | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | Longueur [illegible] | » 30 | » 40 | » 50 | » 50 | » 75 | » 60 | 1 10 | » | » |
| 939 | — [illegible] | » 45 | » 50 | » 75 | » 60 | 1 15 | 1 35 | 1 65 | » | » |
| 940 | — [illegible] | » 50 | » 65 | » 80 | 1 » | 1 20 | 1 40 | 1 90 | 2 50 | 3 » |
| 940 bis | — [illegible] | 1 50 | 1 75 | 2 50 | 3 » | 4 » | 5 » | 6 50 | 8 50 | 10 50 |

[illegible] se font aussi en d'autres longueurs. Prix spéciaux suivant la longueur, l'épaisseur de la feuille employée et la quantité demandée.

*Tous ces drains non perforés, c'est-à-dire sans yeux : réduction 10 %.*

941 **Drain à demeure du Dr Bonnaire,** caoutchouc rouge, 8 à 10 m/m de diamètre, longueur [illegible] c/m. La pièce 2 75

Sur demande, se [illegible] aussi de 12 à 20 m/m

942 **Drains feuille anglaise,** forme en [illegible]. La pièce 3 »

943 **Drains feuille anglaise de Greenhalgh** La pièce 2 50

DELAMOTTE

# Divers




944 **Pinces m[illegible]** [illegible] tubes caoutchouc — La pièce » 50

945 **Raccord,** robinet à double clave — » 70

946 **Raccord** [illegible] — » 75

947 **Raccord à échelle,** sans [illegible] — » 50

948 **Raccord double,** spécial pour tubes [illegible] caoutchouc — » 20

949 **Raccord cristal,** pour double [illegible] *Ref. 877 et 910* — » 15

950 — **étain,** Bagnères de Bigorre. *[illegible] Ref. 903* — 1 50

951 — **porcelaine,** pour canules à [illegible] chaude. *[illegible] Ref. [illegible]* — » 35

952 **Filières en métal,** [illegible] à 30 Charrière — 2 »

953 — **en carton,** Charrière. *Prix suivant quantités*

| 1907 | | 1908 | | | | 1909 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |

**DELAMOTTE**

| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | | 1906 | | | | 1909 | | |

**Installation spéciale pour la fabrication rapide et soignée de tous Instruments et Appareils en caoutchouc moulé**

# Table des Matières


| | | |
|---|---|---|
| Co[illegible] | Page 2 couverture | |
| Re[illegible] | Page 2 | |
| St[illegible] | Page 35 et 36 | |

| | en Gomme Pages | en Caoutchouc Pages |
|---|---|---|
| [illegible] | 3 à 5 | |
| — [illegible] | 5 | |
| — [illegible] | 5 à 7 | |
| [illegible] | 8-9 | |
| [illegible] | 10 | |
| — [illegible] | 11 à 14 | |
| — [illegible] | 11 à 13 | |
| [illegible] | 10 | |
| [illegible] Sondes à lavage | 15 à 17 | |
| [illegible] | 16 | |
| [illegible] courant | 16-23-31 | 39-43 à 45 |
| [illegible] | 18 21 31 | |
| Sondes [illegible] stéscopiques vésico-urétérales | 19 | |
| Bougies dilatatrices œsophagiennes | 20 | |
| S[illegible] œsophagiennes | 21 | 40-41 |
| Canules pour le nez et les oreilles | [illegible] | 49 |
| — dilatatrices du rectum | 23 | 47 |
| — pour lavements | 24 | 42 43 |
| — pour injections vaginales | [illegible] | 47 48 |
| Spéculums pour les bains | 25 | |
| Bandages et Pelotes herniaires | 26 à 30 | |
| Instruments vétérinaires | 31 | |
| Sondes et Bougies Nélaton | | 37-38 |
| — rectales spéciales | 23 | 13 à 45 |
| Drains | | 50 |
| Sondes à demeure | | 38 39 |
| Objets divers | 33 34 31 | |
| Boîtes à Sondes | 32-33 | |